210107_HEM-6232T-BR_OH-IM_pt-br.fm Page 1 Thursday, January 7, 2021 1:39 PM

OMRON

Monitor de Pressão Arterial de Pulso

Modelo HEM-6232T
Manual de Instruções

HEM-6232T-BR
3608275-0E

All for Healthcare

Sumário

Introdução
Informações de segurança importantes
1. Conheça seu monitor
2. Preparação
3. Como usar seu monitor sem um dispositivo inteligente
4. Como usar seu monitor junto com um dispositivo inteligente
5. Como usar a função de memória
6. Outras configurações
7. Mensagens de erro e solução de problemas
8. Manutenção
9. Como reciclar e descartar o monitor e as pilhas
10. Especificações
11. Garantia
12. Orientações e declaração do fabricante

Introdução

Obrigado por adquirir o Monitor de Pressão Arterial de Pulso OMRON HEM-6232T. Use este monitor de pressão arterial em seu pulso.
Este novo monitor de pressão arterial usa o método oscilométrico para a medição da pressão arterial. Quando a braçadeira se inflar, o monitor sentirá as pulsações da pressão da artéria sob a braçadeira. Os pulsos são chamados de pulsos oscilométricos. O sensor eletrônico de pressão exibe uma leitura digital da pressão arterial.

Instruções de segurança

Este manual de instruções apresenta informações importantes sobre o Monitor de Pressão Arterial de Pulso OMRON HEM-6232T. Para usar este monitor corretamente e com segurança, LEIA e COMPREENDA todas as instruções de segurança e operação. Se você não entender estas instruções ou tiver dúvidas, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil antes de tentar usar o monitor. Para informações específicas sobre sua própria pressão arterial, consulte seu médico.

Uso pretendido

O aparelho é um monitor digital que se destina a medir a pressão arterial e a frequência cardíaca em pacientes adultos, cuja circunferência do pulso esteja entre 13,5 cm e 21,5 cm. Este monitor detecta a ocorrência de batimentos cardíacos irregulares durante a medição e exibe um sinal de advertência na leitura. Ele foi projetado principalmente para uso doméstico comum.

Recebimento e inspeção

Remova o monitor da embalagem e veja se não está danificado. Se o monitor estiver danificado, NÃO USE e entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil.

Informações de segurança importantes

Leia as Informações de segurança importantes neste manual de instruções antes de usar o monitor.
Para sua segurança, siga este manual de instruções em sua totalidade.
Guarde o manual para consultas futuras. Para informações específicas sobre sua própria pressão arterial, CONSULTE SEU MÉDICO.

⚠Advertência — **Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.**

- **O monitor não deve ser usado para a medição invasiva.**
- **NÃO use este monitor em bebês, crianças de todas as idades ou pessoas que não consigam se expressar.**
- **NÃO ajuste a medicação segundo as leituras deste monitor de pressão arterial. Siga a medicação prescrita pelo médico. SOMENTE o médico está qualificado para diagnosticar e tratar a pressão arterial alta.**
- **NÃO use o dispositivo em um pulso ferido ou sendo tratado clinicamente.**
- **NÃO coloque a braçadeira no pulso se estiver recebendo uma infusão intravenosa ou transfusão de sangue.**
- **NÃO use este monitor em locais com equipamentos cirúrgicos de alta frequência (AF), ressonância nuclear magnética (RNM), tomografia computadorizada (TC) ou em ambientes ricos em oxigênio. Eles podem provocar erro no funcionamento do monitor e/ou uma leitura imprecisa.**
- **O monitor não deve ser usado na presença de anestésico inflamável contendo ar, oxigênio ou óxido nitroso.**
- **Consulte seu médico antes de usar o monitor se você apresentar arritmias comuns, tais como extrassistole atrial ou ventricular, fibrilação atrial, esclerose arterial, perfusão insatisfatória, diabetes, se estiver gestante, apresentar pré-eclâmpsia ou doença renal. TENHA EM ATENÇÃO que esses quadros clínicos e também se o paciente se movimentar, tremer ou sentir calafrios podem afetar a leitura.**
- **NUNCA diagnostique ou trate a si mesmo segundo suas próprias leituras. SEMPRE consulte seu médico.**
- **Este produto contém peças pequenas que poderão representar um risco de asfixia se ingeridas por bebês ou crianças de todas as idades.**

Transmissão de dados

- **Este produto emite radiofrequência (RF) na faixa 2,4 GHz. NÃO use este produto em locais em que não seja permitida a emissão de RF, como em aviões ou em hospitais. Desligue o recurso Bluetooth no monitor e remova as pilhas quando estiver nessas áreas.**

Manuseio e uso das pilhas

- **Mantenha as pilhas fora do alcance de bebês e crianças de todas as idades.**

⚠Cuidado — **Indica uma situação que pode ser perigosa e, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada do usuário ou paciente ou danificar o equipamento ou outros bens.**

- **Pare de usar o monitor e consulte seu médico se você sentir irritação na pele ou desconforto.**
- **Consulte seu médico antes de usar o monitor se houver um acesso intravascular, terapia por via intravascular ou fístula arteriovenosa (AV) em seu pulso. O monitor provoca uma interferência temporária no fluxo sanguíneo que pode resultar em lesão.**
- **Consulte seu médico antes de usar o monitor se você tiver feito uma mastectomia.**
- **Consulte seu médico antes de usar o monitor se você apresentar problemas graves do fluxo sanguíneo ou transtornos do sangue, pois o enchimento da braçadeira pode provocar contusão.**
- **NÃO meça a pressão mais vezes do que o necessário, pois pode provocar contusão, por causa da interferência no fluxo sanguíneo.**
- **Infle a braçadeira SOMENTE quando ela estiver no pulso.**
- **Remova a braçadeira de punho se ela não começar a se desinflar durante a medição.**
- **NÃO use este monitor para qualquer outro fim que não seja medir a pressão arterial.**
- **Na medição, confirme se não há nenhum dispositivo móvel ou outro dispositivo elétrico que emita campos eletromagnéticos a 30 cm do monitor. Eles podem provocar erro no funcionamento do monitor e/ou uma leitura imprecisa.**
- **NÃO desmonte ou tente consertar este monitor ou outros componentes, pois isso pode provocar uma leitura imprecisa.**
- **NÃO use em local úmido ou onde haja o risco de cair água no monitor, pois isso pode danificar o aparelho.**
- **NÃO use este monitor em um veículo em movimento, como no carro.**
- **NÃO deixe o monitor cair, não o sujeite a choques ou vibrações fortes.**
- **NÃO use este monitor em locais úmidos com alta ou baixa umidade ou com temperaturas muito altas ou baixas. Consulte o capítulo 10.**
- **Durante a medição, observe o braço para assegurar que o monitor não está causando interrupção prolongada da circulação sanguínea.**
- **NÃO use este monitor em ambientes com muito movimento, como clínicas ou consultórios médicos.**
- **NÃO use este monitor com outros equipamentos eletromédicos ao mesmo tempo. Eles podem provocar erro no funcionamento do monitor e/ou uma leitura imprecisa.**
- **Evite tomar banho, consumir bebidas alcoólicas ou cafeína, fumar, exercitar-se e comer 30 minutos antes de medir a pressão.**
- **Descanse por, no mínimo, 5 minutos antes de medir a pressão.**
- **Tire roupas justas ou grossas e qualquer acessório que estiver no punho quando for medir a pressão.**
- **Fique parado e NÃO fale quando estiver medindo a pressão.**
- **Use este monitor SOMENTE em pessoas cuja circunferência do pulso caiba na circunferência específica da braçadeira.**
- **Deixe este monitor se estabilizar à temperatura ambiente antes de medir a pressão. Medir após uma mudança extrema de temperatura poderá provocar uma leitura imprecisa. A OMRON recomenda esperar cerca de 2 horas até que o monitor esfrie ou aqueça ao utilizá-lo após ter sido armazenado na temperatura máxima ou mínima de armazenamento. Para mais informações sobre as temperaturas de funcionamento e armazenamento/transporte, consulte o capítulo 8.**
- **NÃO dobre demais a braçadeira de pulso.**
- **NÃO use este monitor após a vida útil do mesmo ter terminado. Consulte a seção 10.**

Transmissão de dados

- **NÃO troque as pilhas enquanto a leitura estiver sendo transferida para seu dispositivo inteligente, pois pode provocar erro no funcionamento do monitor e na transferência dos dados da pressão arterial.**

Manuseio e uso das pilhas

- **NÃO coloque as pilhas com a polaridade voltada para o lado errado.**
- **Use SOMENTE 2 (duas) pilhas alcalinas AAA no monitor. NÃO use outros tipos de pilha. NÃO use pilhas novas junto com pilhas usadas.**
- **Remova as pilhas se não for usar o monitor por um longo período.**
- **Se o líquido da pilha entrar em contato com os olhos, enxágue imediatamente com bastante água limpa. Consulte seu médico imediatamente.**
- **Se o líquido da pilha entrar em contato com a pele, lave-a imediatamente com bastante água limpa e morna. Se a irritação, lesão ou dor persistir, consulte seu médico.**
- **NÃO use as pilhas depois da data de validade.**
- **Verifique as pilhas periodicamente para garantir que estejam funcionando bem.**
- **Use SOMENTE o tipo específico de pilha indicada para esse monitor. Usar pilhas incompatíveis poderá danificar e/ou representar um risco para o monitor.**

1. Conheça seu monitor

1.1 Conteúdo

Monitor, 2 (duas) pilhas alcalinas AAA, estojo, manual de instruções, instruções de configuração

1.2 Monitor

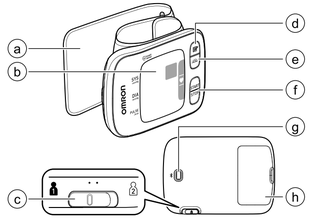

a. Braçadeira de pulso (Circunferência da braçadeira compatível com pulso de 13,5 cm a 21,5 cm)
b. Visor
c. Botão para [troca de usuário]
d. Botão de [memória]
e. Botão da [média matinal]
f. Botão START/STOP
g. Botão de [conexão]
h. Compartimento das pilhas

1.3 Visor e símbolos

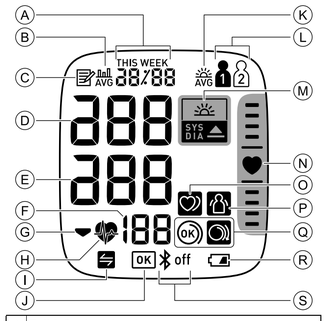

A		**Exibição de data e hora**
B	AVG	**Símbolo de valor médio** Aparecerá na exibição da média das últimas 2 ou 3 leituras medidas há 10 minutos.
C		**Símbolo de memória** Aparecerá na exibição das leituras armazenadas na memória.
D		**Leitura da pressão arterial sistólica**
E		**Leitura da pressão arterial diastólica**
F		**Exibição do pulso/Número da memória** A frequência cardíaca (pulsação) aparece depois da medição. Pressione o botão para que o número da memória apareça por aproximadamente 1 segundo antes de a frequência cardíaca aparecer no visor.
G		**Símbolo de esvaziamento** Aparece durante o esvaziamento da braçadeira.
H		**Símbolo de batimentos cardíacos** Pisca durante a medição.
I		**Símbolo de sincronização** Piscará/Aparecerá quando seus dados precisarem ser transferidos pelo fato de a memória estar quase cheia ou totalmente cheia. Depois de conectar o monitor ao dispositivo inteligente, transfira as leituras imediatamente, antes que o monitor exclua as leituras mais antigas. Até 100 leituras podem ser armazenadas na memória interna, por usuário.
J	OK	**Símbolo OK** Piscará quando o monitor estiver conectado ao dispositivo inteligente ou quando as leituras tiverem sido transferidas com sucesso.
K	AVG	**Símbolo da média matinal** Aparece na visualização da média das leituras da semana medidas pela manhã. O visor exibe a média das pressões medidas pela manhã nas quatro (4) semanas anteriores.
L		**Símbolo da ID do usuário** O número que identifica o usuário (a identificação, ou ID) aparecerá quando o usuário for selecionado com o botão para troca de usuário.
M		**Símbolo de hipertensão** Aparecerá se a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 135 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica for maior ou igual a 85 mmHg.
		Símbolo de hipertensão matinal Aparecerá quando as médias semanais pela manhã forem maiores ou iguais a 135/85 mmHg.
N		**Indicador de posicionamento** O monitor tem um indicador embutido de posicionamento avançado, que é usado para ajudar a determinar se o monitor está na altura correta. O símbolo ♥ ficará azul quando o monitor estiver na posição correta em relação ao coração, durante a medição. Quando o monitor estiver acima ou abaixo do coração, a barra que localiza o coração aparecerá acima ou abaixo do símbolo do coração, para orientar o posicionamento correto do punho.
O		**Símbolo de batimentos cardíacos irregulares** Aparecerá na leitura quando se detectar um ritmo irregular 2 (duas) ou mais vezes durante a medição. O ritmo irregular do batimento cardíaco é definido como um ritmo 25% menor ou 25% maior que o ritmo médio detectado pelo monitor na medição da pressão arterial. Se ele continuar aparecendo, recomendamos que consulte seu médico e siga suas orientações. Batimentos cardíacos normais Pulso Pressão arterial Batimentos cardíacos irregulares Curto Longo Pulso Pressão arterial
P		**Símbolo de erro de movimento** Aparecerá na leitura quando você mover o corpo durante a medição. Se aparecer, remova a braçadeira de pulso e aguarde de 2 a 3 minutos. Depois, fique parado e faça a medição novamente.
Q	OK	**Símbolo que indica o encaixe da braçadeira (OK)** Aparecerá se a braçadeira estiver encaixada no pulso corretamente para medir a pressão. Também aparecerá nas leituras armazenadas na memória do produto.
		Símbolo que indica o encaixe da braçadeira Aparecerá se a braçadeira de pulso não for colocada corretamente ao medir a pressão. Também aparecerá nas leituras armazenadas na memória do produto.
R		**Símbolo da pilha (fraca)** Piscará quando a pilha estiver fraca.
		Símbolo da pilha (esgotada) Aparecerá quando a pilha tiver acabado.
S		**Símbolo de Bluetooth** Aparecerá quando o Bluetooth estiver habilitado.
	off	**Símbolo de Bluetooth** Aparecerá quando o Bluetooth estiver desabilitado.

Diretrizes de 2013 da ESH/ESC* para o manejo da hipertensão arterial
Definições da hipertensão de acordo com os níveis de pressão arterial no consultório e em casa.

	Consultório	Casa
Pressão arterial sistólica	≥ 140 mmHg	≥ 135 mmHg
Pressão arterial diastólica	≥ 90 mmHg	≥ 85 mmHg

Estes valores são provenientes de valores estatísticos para a pressão arterial.

* Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH) e Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC).

⚠Advertência
- NUNCA diagnostique ou trate a si mesmo segundo suas próprias leituras. SEMPRE consulte seu médico.

2. Preparação

2.1 Como instalar as pilhas

1. Empurre a parte saliente da tampa que cobre as pilhas e puxe para baixo.

2. Insira 2 (duas) pilhas alcalinas AAA, conforme indicado no compartimento das pilhas.

3. Feche a tampa das pilhas.



Observações
- Quando o símbolo " " piscar no visor, estará na hora de trocar as pilhas.
- Para trocar as pilhas, desligue o monitor e remova todas as pilhas. Substitua por 2 (duas) pilhas alcalinas novas ao mesmo tempo.
- Assim que as pilhas forem instaladas corretamente, o ano piscará no local do visor que exibe data e hora, para que você possa configurar.
- Trocar as pilhas não vai excluir as leituras anteriores.
- As pilhas fornecidas com o aparelho podem ter uma duração mais curta.
- Descarte as pilhas usadas segundo a legislação local.

2.2 Como configurar data e hora

Observações
- Configure o monitor com a data e a hora corretas antes de medir a pressão pela primeira vez.
- Assim que as pilhas forem instaladas corretamente, o ano piscará no visor do monitor.
- A data e a hora serão automaticamente configuradas quando o monitor for conectado ao aplicativo "OMRON connect". Consulte a seção 4.1.

1. Aperte ou uma vez, para ajustar o ano.
   Aperte e segure para avançar rapidamente pelos anos.
   Aperte e segure para voltar rapidamente pelos anos.
2. Aperte o botão START/STOP para confirmar se o ano e mês piscarão no visor. Repita os mesmos passos para alterar o mês, dia, hora e minuto.



3. Aperte o botão START/STOP para armazenar a configuração.
   Ele se desligará automaticamente após 3 segundos.

Observações
- Se você precisar reconfigurar a data e a hora, troque as pilhas ou aperte o botão até que o ano pisque. Configure a data e a hora seguindo os passos acima.

2.3 Dicas para medir a pressão arterial

Para garantir uma leitura precisa, siga estas orientações:
- O estresse aumenta a pressão arterial. Evite realizar medições durante períodos de estresse.
- As medições devem ser feitas em um local calmo.
- É importante medir a pressão no mesmo horário, todos os dias. Recomenda-se medir a pressão pela manhã e à noite.
- Lembre-se de registrar, para seu médico, as leituras de sua pressão arterial e do pulso. Uma única medição não fornece indicação precisa de sua verdadeira pressão arterial. É necessário realizar e registrar várias medições ao longo de um período.

⚠Cuidado
- Evite tomar banho, consumir bebidas alcoólicas ou cafeína, fumar, exercitar-se e comer 30 minutos antes de medir a pressão.
- Descanse por, no mínimo, 5 minutos antes de medir a pressão.

2.4 Como colocar a braçadeira no pulso

Observações
- Os seguintes passos devem ser seguidos para colocar a braçadeira no pulso esquerdo. Para medir a pressão no pulso direito, coloque a braçadeira seguindo os mesmos passos usados para o pulso esquerdo.
- A pressão arterial pode ser diferente nos punhos direito e esquerdo; e os valores da pressão medida neles, também. A OMRON recomenda usar sempre o mesmo punho para medir a pressão. Se os valores dos dois punhos diferirem muito entre si, peça que seu médico oriente em qual punho você deve medir a pressão.

⚠Cuidado
- Tire roupas justas ou grossas e qualquer acessório que estiver no punho quando for medir a pressão.

1. Coloque a braçadeira no pulso esquerdo.
   Se necessário, levante a manga da camisa. Certifique de que a manga levantada não está apertando o braço, pois isso pode dificultar a circulação sanguínea no braço.



2. Passe o braço pela abertura da braçadeira.
   A palma da mão e o visor do monitor devem ficar voltados para cima.

3. Posicione a braçadeira de pulso deixando uma folga de aproximadamente 1 a 2 cm entre a braçadeira e a parte inferior da palma.



4. Encaixe a braçadeira no pulso com firmeza. Não coloque sobre a roupa.
   Confirme se não há um espaço entre o pulso e a braçadeira.

Observações
- Certifique-se de que a braçadeira de pulso não esteja cobrindo a parte saliente do osso na parte externa do pulso.
- Se a braçadeira de pulso sair da fivela de metal, coloque-a no lugar seguindo a orientação na figura.



2.5 Como sentar-se corretamente

Para medir a pressão, você precisa estar relaxado e sentado confortavelmente em um local com temperatura ambiente. Coloque o cotovelo na mesa para apoiar o braço.

- Sente-se em uma cadeira, sem cruzar as pernas e com os pés apoiados no chão.
- Sente-se com as costas e o braço apoiados.
- O monitor deve estar aproximadamente na mesma altura que o coração. Se o monitor estiver muito acima do coração, a pressão arterial medida será artificialmente baixa. Se o monitor estiver muito abaixo do coração, a pressão arterial medida será artificialmente alta.
- Relaxe o pulso e a mão. Não dobre o pulso para trás, não feche os dedos da mão, nem incline o pulso para frente.

2.6 Como selecionar a ID de um usuário

Seu monitor foi projetado para medir e armazenar as leituras na memória de 2 (duas) pessoas usando o botão para troca de usuário.

1. Selecione a ID do o usuário 1 ou 2.

3. Como usar seu monitor sem um dispositivo inteligente

3.1 Como realizar uma medição

Você pode usar o monitor sem conectá-lo a um dispositivo inteligente. Para conectar o monitor ao dispositivo inteligente, consulte a seção 4.1.

Observações
- Para interromper a medição, pressione o botão START/STOP uma vez para desinflar a braçadeira de pulso.

⚠Cuidado
- NÃO use este monitor com outros equipamentos eletromédicos ao mesmo tempo. Eles podem provocar erro no funcionamento do monitor e/ou uma leitura imprecisa.
- Fique parado e NÃO fale quando estiver medindo a pressão.

1. Pressione o botão START/STOP.
   Todos os símbolos aparecem no visor antes do monitor começar a medir a pressão.
2. Verifique o indicador de posicionamento.
   O monitor tem um indicador embutido que indica a região do coração, que é usado para ajudar a determinar se o monitor está na altura correta. Ele foi projetado para funcionar com a maioria das pessoas, de modo a que quando o pulso estiver na posição correta com relação ao coração, o símbolo ♥ ficará azul. Quando o pulso estiver mais acima ou mais abaixo do coração, uma barra localizadora aparecerá, indicando a posição do pulso. Como a anatomia varia de pessoa para pessoa, esse recurso pode não ser útil em todos os casos. Talvez, você prefira desligar o recurso. Se você achar que a posição do pulso em relação ao indicador de posicionamento NÃO corresponder à altura de seu coração, desabilite esse recurso e siga sua própria opinião. Para desativá-lo, consulte a seção 6.1.



	Altura do monitor	Indicador de posicionamento
♥	Pulso muito para cima	Uma barra localizadora (-) acima do símbolo ♥ já indica que está muito para cima.
	Bem posicionado	O símbolo ♥ fica azul.
	Pulso muito para baixo	Uma barra localizadora (-) abaixo do símbolo ♥ já indica que está muito para baixo.

Observações
- Depois de pressionar o botão START/STOP por 5 segundos, mesmo sem estar bem posicionado, o monitor começará a medir a pressão e a braçadeira começará a se inflar.

3. Fique parado e não se mova ou fale antes de todo o processo de medição estar concluído.
   À medida que a braçadeira se inflar, o monitor determinará automaticamente o nível ideal de enchimento. O monitor detecta a pressão arterial e frequência cardíaca durante o enchimento.
   O símbolo ♥ piscará a cada batimento cardíaco.

Observações
- O símbolo OK aparecerá se a braçadeira de pulso estiver encaixada no pulso corretamente.
- Quando o símbolo for exibido, a braçadeira de pulso não terá sido encaixada corretamente. Aperte o botão START/STOP para desligar o monitor e coloque a braçadeira corretamente.

Após o monitor detectar a pressão arterial e a frequência cardíaca, a braçadeira irá desinflar automaticamente. A pressão arterial e a frequência cardíaca serão exibidas.
Se a leitura sistólica ou diastólica estiver alta (consulte a seção 1.3), o símbolo aparecerá.



4. Aperte o botão START/STOP para desligar o monitor.

Observações
- O monitor desligará automaticamente após 2 minutos.
- Entre as medições, faça uma pausa de 2 a 3 minutos. Esse tempo é para que as artérias se descomprimam e voltem à forma normal anterior à medição. Pode ser necessário aumentar o tempo de espera, dependendo das características fisiológicas individuais.

4. Como usar seu monitor junto com um dispositivo inteligente

4.1 Como conectar seu monitor a um dispositivo inteligente

A data e a hora de seu monitor serão configuradas automaticamente quando você conectar o monitor a um dispositivo inteligente.
Consulte a lista de dispositivos inteligentes compatíveis em www.omronconnect.com/devices

1. Habilite o Bluetooth em seu dispositivo inteligente.
2. Baixe e instale gratuitamente o aplicativo OMRON connect em seu dispositivo inteligente.

Download on the App Store — GET IT ON Google Play

   Se você já tiver o aplicativo "OMRON connect", abra o aplicativo e adicione o novo monitor.
3. Abra o aplicativo em seu dispositivo inteligente e siga as instruções.
4. Confirme se o monitor foi conectado com sucesso.



   Se o monitor estiver conectado com sucesso ao dispositivo inteligente, o símbolo "OK" aparecerá no visor.

Observações
- Se o símbolo "Err" aparecer, siga as instruções no aplicativo "OMRON connect".
- Seu monitor se desligará automaticamente depois de 10 segundos de inatividade.
- Qualquer leitura armazenada atualmente na memória de seu monitor será transferida automaticamente para o aplicativo depois da conclusão com sucesso do processo de conexão.
- Esteja ciente de que a OMRON não é responsável pela perda de dados e/ou informações no aplicativo.
- "OMRON connect" é o único aplicativo que recomendamos usar com o monitor para transferir os dados corretamente.

4.2 Como realizar uma medição

Para medir a pressão, siga as instruções da seção 3.1. Os dados coletados pelo monitor serão transferidos para o aplicativo em seu dispositivo inteligente.

Observações
- Se seu perfil foi registrado, basta pressionar o botão [START/STOP] para exibir seu aniversário e fazer o símbolo da ID do usuário piscar duas vezes.
- O registro de um perfil está disponível no aplicativo "OMRON connect". Consulte a seção 4.1.

210107_HEM-6232T-BR_OM-IM_pt-br.fm Page 2 Thursday, January 7, 2021 1:39 PM

4.3 Como desabilitar/habilitar o Bluetooth

Desabilite o Bluetooth em seu monitor nas áreas a seguir, em que o uso de equipamento sem fio é proibido.
• No avião • No hospital • Em outro país
O padrão de fábrica é que o Bluetooth venha habilitado.

1. Com o monitor desligado, aperte e segure o botão [ᛒ] por mais de 10 segundos.
   • No visor, aparecerá a palavra "oFF".

• Quando o Bluetooth estiver desabilitado, o símbolo a seguir aparecerá.



Observações
• Para habilitar o Bluetooth, aperte e segure o botão [ᛒ] por mais de 2 segundos. No visor, aparecerá a palavra "on".
• Seu monitor se desligará automaticamente, 3 segundos depois que você terminar.

5. Como usar a função de memória

O monitor armazena automaticamente até 100 leituras por usuário.

5.1 Como ver as leituras na memória

1. Selecione sua ID do usuário.
2. Pressione o botão [ ].

Alternar a exibição de data/hora

O número da memória aparece por 1 segundo, antes que a frequência cardíaca seja exibida. A leitura mais recente é a de número "1".

Observações
• Se o indicador de posicionamento estiver habilitado, ele será exibido na leitura.
• Se a leitura estiver muito alta (consulte a seção 1.3), o símbolo HI aparecerá.
• Se não houver nenhuma leitura armazenada na memória, a tela à direita será exibida.
• Se a memória estiver cheia, o monitor excluirá as leituras mais antigas.

3. Aperte o botão [ ] repetidamente para navegar pelas leituras antigas armazenadas na memória.

5.2 Como ver a leitura média

O monitor é capaz de calcular uma leitura média com base nas últimas 2 ou 3 leituras medidas há 10 minutos.

1. Selecione sua ID do usuário.
2. Com o monitor desligado, aperte e segure o botão [ ] por mais de 2 segundos.



Observações
• Se houver apenas 2 (duas) leituras na memória nesse período, a média será baseada nessas 2 (duas) leituras.
• Se a leitura média estiver muito alta (consulte a seção 1.3), o símbolo HI aparecerá.

5.3 Como ver a média semanal matinal

Seu monitor calcula e exibe as médias semanais das medições feitas pela manhã nas últimas 4 (quatro) semanas.

1. Selecione sua ID do usuário.
2. Pressione o botão [ ] uma vez.
   A média semanal da manhã da semana atual, THIS WEEK, aparece no visor.
   Se a média semanal da manhã estiver muito alta (consulte a seção 1.3), o símbolo "HI" aparecerá.



3. Pressione o botão [ ] repetidamente para exibir a média das semanas anteriores.
   No monitor, -1 WEEK identifica a média da semana anterior; e -3 WEEK, o conjunto mais antigo de médias.
4. Aperte o botão START/STOP para desligar o monitor.

Cálculo da leitura semanal média da manhã
Essa é a média para as medições feitas durante a manhã (4:00 - 9:59) entre o domingo e o sábado. As 2 ou 3 leituras feitas dentro dos primeiros 10 minutos pela manhã entre 4:00 - 9:59 serão usadas para calcular a média pela manhã de cada dia.

6. Outras configurações

6.1 Como desabilitar/habilitar o sensor de posicionamento

O padrão de fábrica é que o sensor de posicionamento esteja habilitado.

1. Selecione sua ID do usuário.
2. Com o monitor desligado, aperte e segure o botão [ ] por mais de 10 segundos.



Observações
• Seu monitor se desligará automaticamente, 3 segundos depois que você terminar.
• Para habilitar o sensor de posicionamento, siga os mesmos passos acima.

6.2 Como excluir todas as leituras armazenadas na memória

1. Selecione sua ID do usuário.
2. Aperte o botão [ ]. O símbolo [ ] aparece.
3. Segurando o botão [ ], aperte e segure o botão START/STOP por mais de 2 segundos.



Observações
• Todas as leituras serão excluídas. Não é possível excluir parcialmente as leituras armazenadas na memória.

6.3 Como restaurar a configuração padrão do monitor

Para excluir todas as informações armazenadas em seu monitor, siga as instruções abaixo. Certifique-se de que o monitor esteja desligado.

1. Segurando o botão [ ], aperte o botão [START/STOP] por 2 segundos. Pressione ambos os botões por mais de 5 segundos.



Observações
• Reverter as configurações do monitor ao padrão de fábrica não excluirá as informações no aplicativo.
• O monitor desligará automaticamente após 3 SEGUNDOS.
• Você precisará conectar novamente o monitor quando for usá-lo novamente. Sem a reconexão, as leituras não serão transferidas para o aplicativo.

7. Mensagens de erro e solução de problemas

Caso algum dos problemas abaixo ocorra durante uma medição, verifique primeiro se não há nenhum dispositivo elétrico a 30 cm de distância. Se o problema persistir, consulte a tabela abaixo.

Visor/ problema	Causa possível	Solução
E rr aparece ou a braçadeira de pulso não se infla.	A braçadeira de pulso não está bem encaixada.	Coloque a braçadeira de punho corretamente e meça a pressão novamente. Consulte a seção 2.4.
	O ar está vazando da braçadeira de pulso.	Entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil. Consulte a seção 12.
E3 aparece	A braçadeira de pulso está superinflada e excedeu 300 mmHg.	Não toque a braçadeira de pulso durante a medição.
E4 aparece	Você se moveu ou falou durante a medição. As vibrações atrapalham a medição.	Fique parado e não fale durante a medição.
E5 aparece	A frequência cardíaca não foi detectada corretamente.	Coloque a braçadeira de pulso corretamente e meça a pressão novamente. Consulte a seção 2.4. Fique parado e se sente corretamente durante a medição. Se o símbolo continuar aparecendo, recomendamos que consulte seu médico.
aparece		
aparece		
E7 aparece	Seu pulso se moveu para cima e para baixo durante a medição.	Não mova o pulso e meça a pressão novamente. Consulte a seção 3.
Er aparece	O monitor não funcionou direito.	Aperte o botão [START/STOP] novamente. Se "Er" continuar aparecendo, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil. Consulte a seção 12.
P pisca	O botão ᛒ foi apertado e segurado para se fazer a conexão com um dispositivo inteligente.	Pisca durante a conexão com o dispositivo inteligente. Acesse a seção AJUDA, no aplicativo OMRON connect, para saber mais sobre a conexão.
pisca	O botão ᛒ foi apertado para transferir suas leituras.	Pisca durante a transferência de suas leituras para o aplicativo "OMRON connect". Acesse a seção AJUDA, no aplicativo OMRON connect, para saber mais sobre a conexão.
pisca	Não é possível transferir mais de 80 leituras.	Conecte o dispositivo com o aplicativo OMRON connect ou transfira as leituras para ele, para deixar a memória no aplicativo. Assim, o símbolo de erro desaparecerá.
	O monitor está pronto para se conectar ou transferir as leituras.	
aparece	Não é possível transferir mais de 100 leituras.	
Símbolo de coração O símbolo de coração no indicador de posicionamento não se acende e a barra localizadora não aparece.	O indicador de posicionamento foi desabilitado.	Habilite o indicador de posicionamento. Consulte a seção 6.1.
pisca	As pilhas estão fracas.	Recomenda-se trocar as pilhas por 2 (duas) pilhas alcalinas novas. Consulte a seção 2.1.
aparece ou o monitor foi desligado inesperadamente durante uma medição	A pilha acabou.	Troque imediatamente as pilhas por 2 (duas) pilhas alcalinas novas. Consulte a seção 2.1.
O monitor não liga. Não aparece nada no visor do monitor.	A pilha acabou totalmente.	
	As polaridades da pilha não foram posicionadas corretamente.	Confirme se as pilhas foram instaladas na posição certa. Consulte a seção 2.1.
As leituras parecem estar muito altas ou muito baixas.	A pressão arterial está sempre variando. Muitos fatores, inclusive estresse, hora do dia e/ou a maneira de colocar a braçadeira no pulso podem afetar sua pressão arterial. Leia as seções 2.3 - 2.5 e a seção 3.	
Outro problema de comunicação ocorreu.	Siga as instruções exibidas no dispositivo inteligente ou acesse a seção "AJUDA" no aplicativo "OMRON connect" para obter mais ajuda. Se o problema continuar acontecendo, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil. Consulte a seção 12.	
Outro problema ocorreu.	Aperte o botão START/STOP para desligar o monitor. Aperte novamente para medir a pressão. Se o problema continuar, remova todas as pilhas e aguarde 30 segundos. Depois, recoloque as pilhas. Se o problema continuar acontecendo, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil. Consulte a seção 12.	

8. Manutenção

8.1 Manutenção

Para proteger o seu monitor contra danos, siga as instruções abaixo:
• Alterações ou modificações não aprovadas pelo fabricante anularão a garantia. Não desmonte ou tente reparar o dispositivo ou seus componentes. De acordo com a norma do INMETRO Nº 46/2016, é obrigatório fazer a verificação do aparelho uma vez por ano por uma organização da Rede Brasileira de Metrologia legal e Qualidade do INMETRO (RBMLQ-I). Entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil.
• Mediante solicitação, a OMRON fornece informações sobre assistência técnica ou equipes técnicas credenciadas, descrições, instruções de calibração e outras informações consideradas necessárias para a manutenção adequada.

⚠ Cuidado
• NÃO desmonte ou tente consertar este monitor ou seus componentes. Isso pode provocar uma leitura imprecisa.

8.2 Armazenamento

Guarde o monitor no estojo quando não estiver usando.
• Armazene o monitor em um local limpo e seguro.
Não armazene o monitor:
• Se o monitor estiver molhado.
• Em locais expostos a temperaturas extremas, umidade, luz solar direta, poeira ou vapores corrosivos, como de água sanitária.
• Em locais expostos a vibrações ou choques.

8.3 Limpeza

• Não use produtos de limpeza abrasivos ou voláteis.
• Use um pano leve e seco ou um pano leve umedecido com detergente neutro para limpar o monitor e a braçadeira de pulso. Seque com um pano seco.
• Não lave ou submerja o monitor e a braçadeira de pulso em água.
• Não use gasolina, tíner ou solventes semelhantes para limpar o monitor e a braçadeira de pulso.

9. Como reciclar e descartar o monitor e as pilhas

Descarte o monitor, seus componentes, acessórios opcionais, pilhas e embalagem seguindo a legislação local aplicável. O descarte ilegal pode causar poluição ambiental.
Veja abaixo a forma correta de destinar cada um dos itens contidos na embalagem deste produto:

ITEM	DESTINAÇÃO
Monitor, componentes e acessórios	OMRON Healthcare Brasil ou rede de assistência técnica autorizada
Pilhas	Estabelecimento comercial, rede de assistência técnica autorizada ou pontos de coleta seletiva local
Embalagem (papelão, sacolas e outros componentes de plástico e manuais de instrução)	Coleta seletiva local

Salientamos que despesas referentes ao envio e/ou transporte até a assistência técnica ou outro ponto de coleta serão de responsabilidade do consumidor.

10. Especificações

Modelo	HEM-6232T
Visor	Visor digital LCD
Intervalo de medição de pressão da braçadeira	0 a 299 mmHg
Intervalo de medição de pressão arterial	SYS: 60 a 260 mmHg DIA: 40 a 215 mmHg
Intervalo de medição de pulso	40 a 180 batimentos/minuto
Precisão	Pressão: ±3 mmHg Pulso: ±5% da leitura exibida
Enchimento	Automática, por bomba elétrica
Esvaziamento	Esvaziamento rápido automático
Método de medição	Método oscilométrico
Método de transmissão	Tecnologia **Bluetooth**® com baixo consumo de energia
Comunicação sem fio	Intervalo de frequência: 2,4 GHz (2,400 a 2,483,5 MHz) Modulação: GFSK Potência efetiva irradiada: < 20 dBm
Classificação IP	IP 22
Tensão	3 V CC - 3,0 W
Fonte de alimentação	Duas pilhas alcalinas AAA de 1,5 V
Duração das pilhas	Aproximadamente 300 medições (usando pilhas alcalinas novas)
Tempo de durabilidade	5 anos
Modo de Operação	Operação contínua
Condições de funcionamento	+10°C a +40°C/15% a 90% UR (não condensável)/800 a 1060 hPa
Condições de armazenamento e transporte	-20°C a +60°C/10% a 90% UR (não condensável)
Peso	Aproximadamente 91 g (sem as pilhas)
Dimensões	Aproximadamente 91 mm (largura) × 63 mm (altura) × 13 mm* (comprimento) (não incluindo a braçadeira de pulso)
Circunferência da braçadeira	13,5 a 21,5 cm
Memória	Armazena até 100 leituras por usuário
Conteúdo	Monitor, estojo, 2 (duas) pilhas alcalinas "AAA", manual de instruções, instruções de configuração
Proteção contra choques elétricos	Equipamentos eletromédicos (ME) de alimentação interna
Parte aplicada	Tipo BF (braçadeira de pulso)
Temperatura máxima da parte aplicada	Inferior a +48°C

* parte mais fina

Observações
• Essas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
• No estudo de validação clínica, a quinta fase foi utilizada em 85 pacientes para a determinação da pressão arterial diastólica.
• Este monitor foi clinicamente investigado segundo os requisitos da norma ISO 81060-2 de 2013.
• A classificação IP é o grau de proteção contra penetração de objetos estranhos, segundo a IEC 60529. Este monitor está protegido contra a penetração de objetos sólidos estranhos com diâmetro igual ou superior a 12,5 mm, como um dedo, e contra a queda oblíqua de gotas de água, que pode provocar problemas no funcionamento normal.
• Este dispositivo não foi validado para uso em gestantes.

Sobre a interferência da comunicação sem fio
Este produto funciona na banda ISM não licenciada a 2,4 GHz. Caso este aparelho seja usado perto de outros dispositivos sem fio, como microondas e redes LAN sem fio, que funcionam na mesma banda de frequência deste aparelho, é possível que ocorram interferências.
Se a interferência ocorrer, desligue os outros dispositivos ou mude este aparelho de local antes de tentar usá-lo, para que fique longe desses outros dispositivos sem fio.

11. Garantia

Seu monitor de pressão arterial OMRON HEM-6232T, com exceção das braçadeiras e das pilhas, é garantido como livre de defeitos de materiais e de mão de obra que venham a surgir dentro de 5 anos a partir da data da compra, quando usado de acordo com as instruções fornecidas com este dispositivo. A garantia é invalidada quando os defeitos/danos forem decorrentes de mau uso ou vazamento de pilhas. A braçadeira do monitor tem garantia por defeitos de materiais e de mão-de-obra por 1 ano a partir da data de compra, quando utilizado de acordo com as instruções contidas neste manual. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor final, que adquire o produto no varejo.
O conserto ou a substituição do dispositivo coberto pela garantia descrita acima serão realizados sem custos, se assim for decidido pela OMRON Healthcare Brasil. O conserto ou a substituição é nossa responsabilidade e única solução prevista conforme a garantia acima.
Utilize somente peças específicas, fornecidas pela OMRON Healthcare neste produto. O uso de outras peças que não sejam fornecidas pela OMRON Healthcare poderão comprometer seu funcionamento ou até mesmo causar danos ao aparelho.
Possíveis danos causados em decorrência do uso de peças inadequadas serão de responsabilidade do consumidor e a cobertura pela garantia do produto poderá não ser aplicada.
Siga sempre as orientações de uso, limpeza e armazenamento descritas neste manual. Caso seja constatado o uso em desacordo com as orientações deste manual, a cobertura pela garantia do produto poderá não ser aplicada.
Se o seu dispositivo necessitar de assistência, entre em contato com o SAC da OMRON Healthcare do Brasil.
ESTE DOCUMENTO É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA PELA OMRON EM CONJUNTO COM ESTE DISPOSITIVO, E A OMRON SE DECLARA ISENTA DE QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E OUTROS TERMOS QUE POSSAM SER IMPOSTOS POR LEI, SE HOUVER, SÃO LIMITADOS AO TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO ACIMA. A GARANTIA ACIMA É COMPLETA E EXCLUSIVA.
O GARANTIDOR EXIME-SE EXPRESSAMENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS CASUAIS, ESPECIAIS OU DECORRENTES DE QUALQUER NATUREZA (ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS CASUAIS OU DECORRENTES, PORTANTO, A GARANTIA ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO).
Esta garantia lhe dá direitos legais específicos; você pode também ter outros direitos que variam de acordo com a jurisdição. Devido aos requisitos especiais locais, algumas das limitações e exclusões acima podem não ser aplicáveis ao seu caso.
Para garantir a garantia: Para os clientes que efetuarem o(s) cadastro(s) com a OMRON do(s) monitor(es) de pressão arterial adquirido(s), nossa empresa manterá o compromisso da garantia de 5 anos, mesmo em caso de perda da nota fiscal. O(s) cadastro(s) pode(m) ser efetuado(s) contatando-se o SAC ou através do nosso site www.omronbrasil.com.
ATENÇÃO: Em qualquer um dos casos, todos os campos do(s) cadastro(s) devem estar corretamente preenchidos; para isso, tenha em mãos a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) no momento do cadastro. O(s) cadastro(s) deve(m) ser efetuado(s) no prazo máximo de até 6 meses da data de emissão da nota fiscal do produto.
SAC da OMRON Healthcare Brasil
Grande São Paulo e telefones móveis: (11) 2336-8044
Demais regiões brasileiras: 0800 771 6907
sac@omronbrasil.com
www.omronbrasil.com

12. Orientações e declaração do fabricante

Descrição dos símbolos	
	Parte aplicada – Tipo BF Grau de proteção contra choque elétrico (fuga de corrente)
IP22	O dispositivo está protegido contra objetos estranhos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou mais, como um dedo, e contra gotas d'água com queda oblíqua que podem ocasionar problemas durante a operação normal.
SN	Número de série
	Limitação de temperatura
	Limitação de umidade
	Limitação da pressão atmosférica
	É necessário que o usuário consulte este manual de instruções.
13,5-21,5cm	Indica o posicionamento correto do monitor no pulso Circunferência do pulso mensurável
	Indica o fabricante do dispositivo médico
	Assinala a data em que o dispositivo médico foi fabricado
ANATEL	Para maiores informações, consulte o site da ANATEL em www.anatel.gov.br
	Este aparelho opera na banda ISM (Industrial, Científico, Médico) não licenciada de 2,4 GHz. Caso este aparelho seja utilizado próximo a outros dispositivos sem fio, incluindo microondas e rede local sem fio, que operam na mesma banda de frequência deste aparelho, existe a possibilidade de que ocorra interferência entre este aparelho e outros dispositivos. Se ocorrer tal interferência, interrompa o funcionamento dos outros dispositivos ou reposicione este aparelho antes de usá-lo ou não use este aparelho próximo dos outros dispositivos sem fio.
	Pilha
	Corrente contínua

OMRON Informações do monitor de pressão arterial operado por pilha para os documentos de acompanhamento no escopo da IEC60601-1-2:2014

Informações importantes relacionadas à compatibilidade eletromagnética (EMC)

Este monitor de pressão arterial fabricado pela OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. está em conformidade com a norma de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) IEC60601-1-2 de 2014. No entanto, cuidados especiais devem ser observados:
• O uso de cabos e acessórios diferentes daqueles especificados ou fornecidos pela OMRON pode resultar no aumento de emissão eletromagnética ou na diminuição da imunidade eletromagnética do monitor, ocasionando uma operação inadequada.
• Durante a medição, deve-se evitar o uso do monitor adjacente ou empilhado em outro dispositivo, pois pode ocasionar uma operação inadequada. Caso essa forma de uso seja necessária, o monitor e o outro dispositivo devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.
• Durante a medição, equipamentos de comunicação por RF portáteis (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser usados a pelo menos 12 polegadas (30 cm) de distância de qualquer parte do monitor, incluindo os cabos especificados pela OMRON. Caso contrário, poderá ocorrer uma degradação do desempenho do monitor.
• Consulte as orientações adicionais abaixo a respeito do ambiente EMC no qual o monitor deve ser utilizado.

Tabela 1 - Limites e conformidade de emissão

Fenômeno	Limites de EMISSÃO	Conformidade
EMISSÕES DE RF irradiadas ou conduzidas	CISPR 11	Grupo 1, Classe B
• Testes de EMISSÃO para distorção harmônica, flutuações de tensão e instabilidade não se aplicam, em decorrência de o dispositivo ser um equipamento eletromédico de alimentação interna.		

Tabela 2 - Níveis para teste de imunidade

Fenômeno	Norma básica de EMC	NÍVEIS PARA TESTE DE IMUNIDADE
Descarga eletrostática	IEC 61000-4-2	contato ±8 kV Ar de ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Campos eletromagnéticos de RF irradiada	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campos de proximidade de equipamentos de comunicação sem fio por RF	IEC 61000-4-3	Veja a tabela 3
Campos magnéticos de frequência de potência nominal	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz
• Testes de IMUNIDADE para surtos/transitórios elétricos rápidos, picos linha-a-linha, picos linha-a-terra, distúrbios conduzidos induzidos por campos de RF, quedas de tensão e interrupções de tensão não são aplicáveis devido a equipamentos eletromédicos (ME) de alimentação interna.		

Tabela 3 - Especificações para o teste de imunidade do equipamento à RF proveniente de dispositivos de comunicação sem fio

Frequência de teste (MHz)	Banda (MHz)	Serviço	Modulação	Potência máxima (W)	Distância (m)	NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE (V/m)
385	380 a 390	TETRA 400	Modulação do pulso 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 a 470	GMRS 460, FRS 460	FM Desvio de ± 5 kHz Seno de 1 kHz	2	0,3	28
710 745 780	704 a 787	LTE Banda 13, 17	Modulação do pulso 217 Hz	0,2	0,3	9
810 870 930	800 a 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5	Modulação do pulso 18 Hz	2	0,3	28
1720 1845 1970	1700 a 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Banda 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulação do pulso 217 Hz	2	0,3	28
2450	2400 a 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7	Modulação do pulso 217 Hz	2	0,3	28
5240 5500 5785	5100 a 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulação do pulso 217 Hz	2	0,3	9

ANATEL 13227-20-10304

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Bluetooth®

A marca e o logotipo **Bluetooth**® são marcas registradas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e o uso dessas marcas pela OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. foi previsto em licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são detidos por seus respectivos proprietários.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países.
Google Play e o logótipo de Goole Play são marcas registradas de Google LLC.

Fabricante legal:
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPÃO

Fabricante Real:
OMRON DALIAN Co., Ltd.
No. 3, Song Jiang Road, Economic & Technical Development Zone, Dalian 116600, China

Importado e distribuído no Brasil por:
Omron Healthcare Brasil
Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda
CNPJ: 10.345.462/0008-70
Av Ain Ata (Lot M **II P I** Logistico), 370 - Lote 12 - Quadra B
Jardim Ermida **I** - Jundiaí/SP - CEP: 13,212-213
Responsável técnico: Fernando Mascotte
CREA: Nº 5069525900

SAC da OMRON Healthcare Brasil
Grande São Paulo e telefones móveis: (11) 2336-8044
Demais regiões brasileiras: 0800 771 6907
sac@omronbrasil.com
www.omronbrasil.com
Monitor de Pressão Arterial de Pulso - HEM-6232T
Registro ANVISA n°: 81952070015
Fabricação: Vide 6 primeiros dígitos do número de série (Ano/mês)
Validade: INDETERMINADA

© 2020 OMRON HEALTHCARE, INC.

Segurança

UL BR

ML 197
12/11/18

Fabricado na China
IM-HEM-6232T-BR-04-12/2020